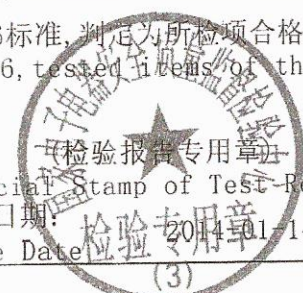


国家电子电器安全质量监督检验中心
NATIONAL CENTER OF SAFETY QUALITY SUPERVISION AND TESTING FOR ELECTRONIC
& ELECTRICAL PRODUCTS

检验报告
TEST REPORT

NO. QTC-418000053

共 4 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	超低温冷柜 (Ultra Low Temperature(ULT) Freezer)	商 标 * Trade Mark	海尔 Haier
规格型号 * Model/Specification	DW-86L728J	样品等级 * Sample Grade	合格品 Accepts
生产单位/地址 * Manufacturer	青岛海尔特种电器有限公司 Haier Medical and Laboratory Products Co., Ltd. / 青岛市海尔工业园 Haier Industrial Park, Qingdao.		
委托单位/地址 * Client	青岛海尔特种电器有限公司 Haier Medical and Laboratory Products Co., Ltd. / 青岛市海尔工业园 Haier Industrial Park, Qingdao.		
送样者 * Sample Delivered by	李军锋	生产日期 * Production Date	2014.01
样品数量 Sample Quantity	1台	样品编号 Sample No.	41800053
送样日期 Sample Delivered Date	2014-01-10	检验类别 Test Type	委托检验 Entrusted Test
检验日期 Test Date	2014-01-10~2014-01-13		
样品状态 Sample Condition	样品外观完好 In good condition		
检验项目 Test Items	耗电量 Power consumption		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T20154-2006		
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品本次检验, 所检项目符合GB/T20154-2006标准, 判定为所检项合格。 According to the standard GB/T20154-2006, tested items of the sample are passed</p> <div style="text-align: right;">  (Special Stamp of Test Report) 签发日期: 2014-01-14 Issue Date: 2014-01-14 (3) </div>		
备注 Notes	带*信息由委托方提供 本报告结果仅对来样负责		
批准: Approved by	陈立升	审核: Verified By	孔宇宇
		主检: Tested By	李莉

国家电子电器安全质量监督检验中心检验报告附页

No. QTC-418000053

共 4 页 第 4 页

标准条款	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
5.4.3	耗电量	≤115%	99.3%	合格
	Power consumption		(额定值Rated value: 10.5 kWh/24h 实测值Measured value: 10.4296 kWh/24h)	

试验说明:

- 试验环境温度: 25℃, 相对湿度: 40%。
Ambient temperature: 25℃, humidity: 40%
- 方法标准: GB/T20154-2006
Means standard: GB/T20154-2006

以 下 空 白

章